

## 報告書変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび骨塩定量検査(CXD法)におきまして測定装置入れ替えを実施いたします。それにともない従来の報告書より下記報告書への変更をいたしますので、ご案内いたします。


誠に勝手ではございますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具



< 実施日 >

2012年1月4日(水) 受託分より

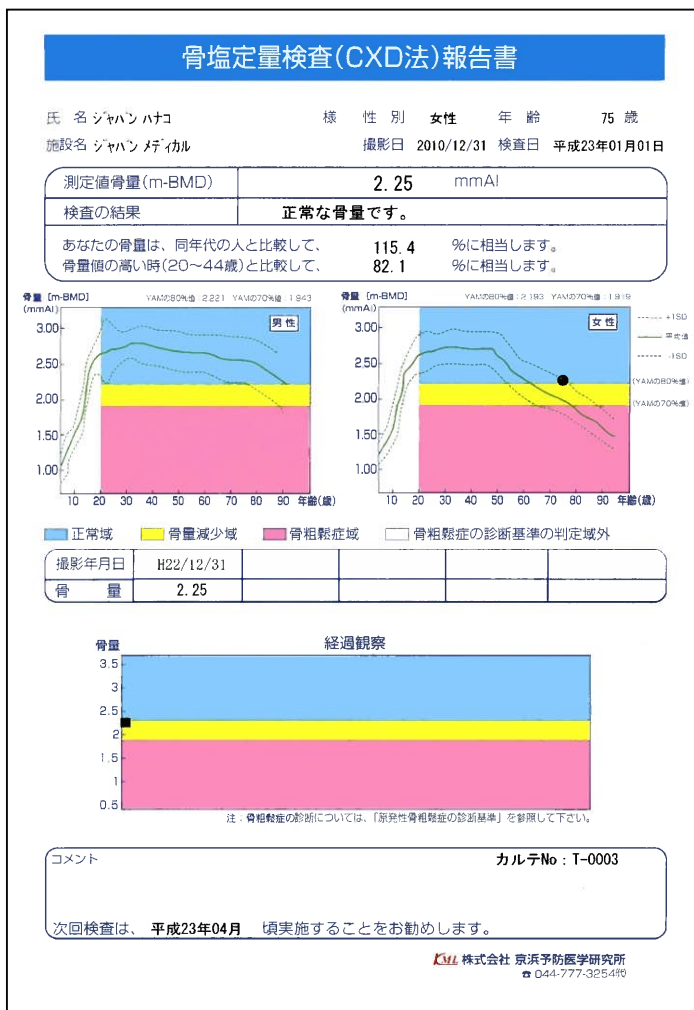

← m-BMD (旧基準値 ΣGS/D) 中指骨骨塩量のアルミ厚さ換算値 (mmAl)

← 上段 AGE% 性別と年齢を一致させた基準値に対する実測値の百分率(%)

下段 YAM% 性別の若年成人平均値(20~44歳)に対する百分率(%)

← 1月4日受託分以降、5回分までの履歴が表示されます。

← 経過観察も同様に表示されます



**株)ジャパンメディカル**  
山梨県中央市乙黒354-11  
Tel 055(220)4155代表