

## 検査内容変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび、下記検査項目におきまして試薬変更にともなう  
検体量、専用容器の変更をご案内いたします。  
誠に勝手ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。


### 記

〈実施日〉

平成 26 年 7 月 1 日 (火) ご依頼分より

コード	検査項目	変更内容	新	現
0451	HCV RNA定量	検体量	血清 1.8ml	血清 3.0ml
		容器	専用容器 Z6 (真空採血量 5ml)	専用容器 Z9 (真空採血量 8ml)

\*外注先 SRL 基準値等の変更はありません。裏面の現法と新法の比較をご参照願います。

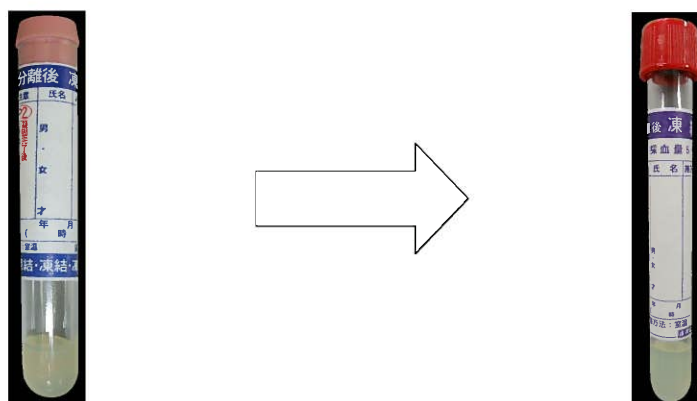


\* 7月1日以降もZ9容器での受付は可能です。在庫無くなり次第Z6容器をお届けいたします。



(株)ジャパンメディカル  
山梨県中央市乙黒354-11  
TEL 055(220)4155代表

\* 現法と新法の比較

0451 : HCVRNA定量

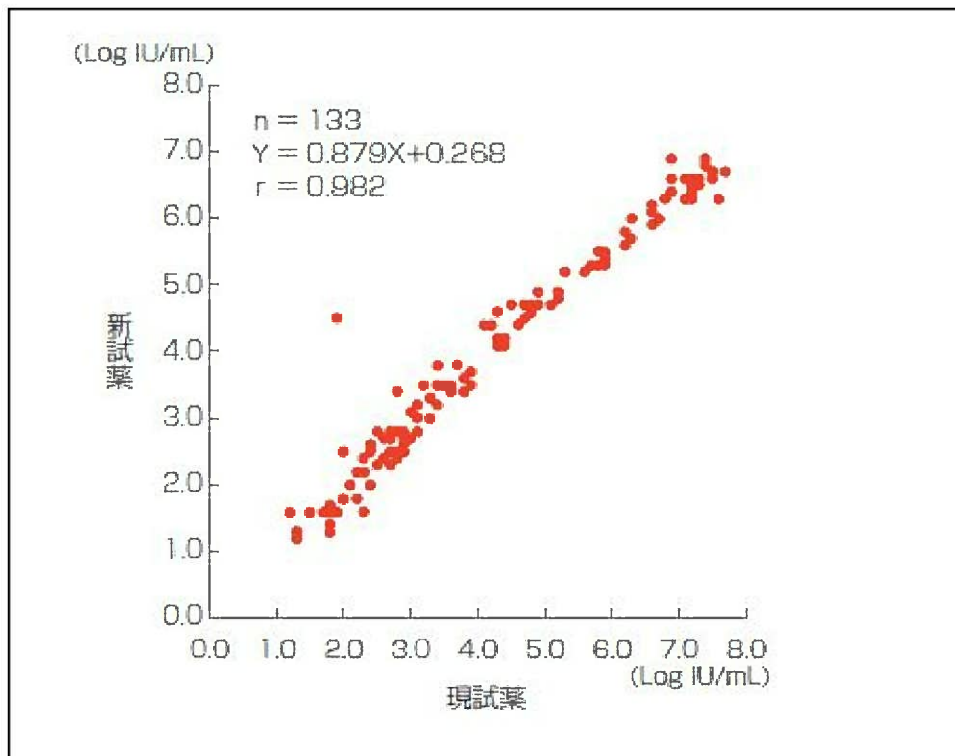

(委託先検討資料)