

検査機器入れ替えに伴う変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび、下記検査項目におきまして外注先での検査機器入れ
 替えに伴う、検査基準値の変更をさせて頂きたくご案内いたします。
 誠に勝手ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。



〈実施日〉

平成 26 年 7 月 22 日 (火) ご依頼分より


コード	項目名	新基準値		新検査方法	現基準値		現検査方法
0722	T3	0.80~1.60 ng/ml		ECLIA	0.8~1.8 ng/ml		CLEIA
0723	T4	6.10~12.40 μ g/dl		ECLIA	5.0~13.0 μ g/dl		CLEIA
0724	FT3	2.30~4.00 pg/ml		ECLIA	2.5~4.5 pg/ml		CLEIA
0725	FT4	0.90~1.70 ng/dl		ECLIA	0.8~1.9 ng/dl		CLEIA
0728	TSH	0.50~5.00 μ U/ml		ECLIA	0.5~4.8 μ U/ml		CLEIA
0745	PRL (プロラクチン)	M:	4.29~13.69 ng/ml	ECLIA	M:	3.7~15.6 ng/ml	CLEIA
		閉経前:	4.91~29.32 ng/ml		F:	4.6~31.7 ng/ml	
		閉経後:	3.12~15.39 ng/ml				
0903	PTH-intact	10~65 pg/ml			10~60 pg/ml		

*外注先 京浜予防医学研究所 裏面の現法と新法の比較をご参照願います。




(株)ジャパンメディカル
 山梨県中央市乙黒354-11
 TEL 055(220)4155代表


●T3現法と新法の比較 (単位: ng/mL)

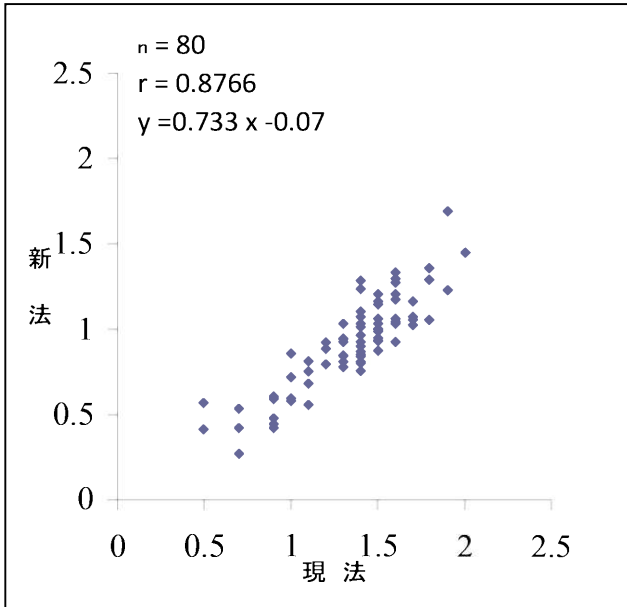


●T4現法と新法の比較 (単位: μ g/dL)

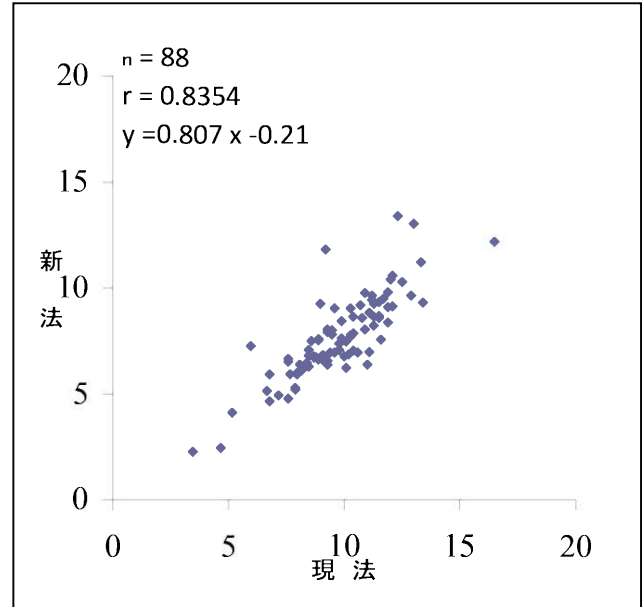


●FT3現法と新法の比較 (単位: pg/mL)

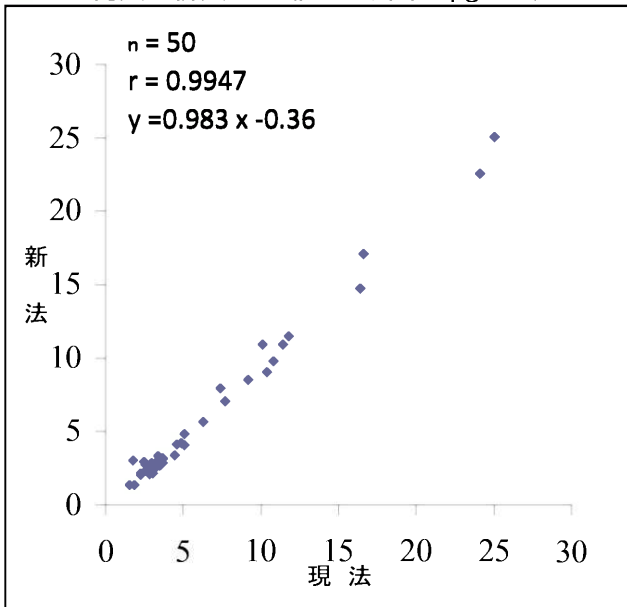


●FT4現法と新法の比較 (単位: ng/dL)

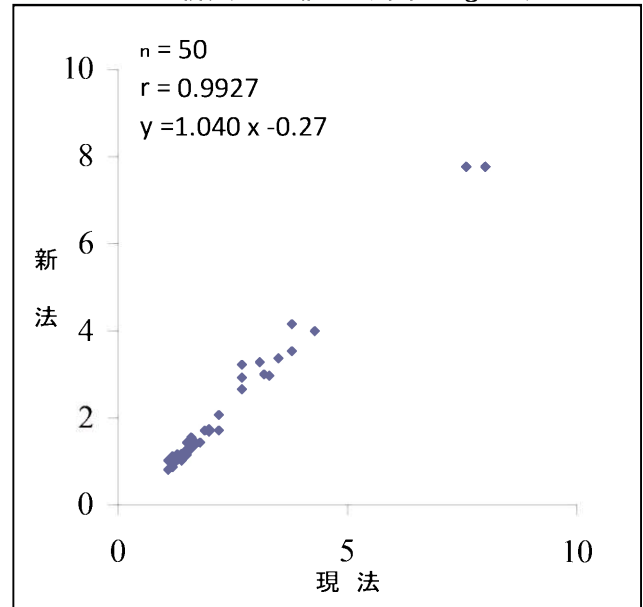

●TSH現法と新法の比較 (単位: μ U/mL)

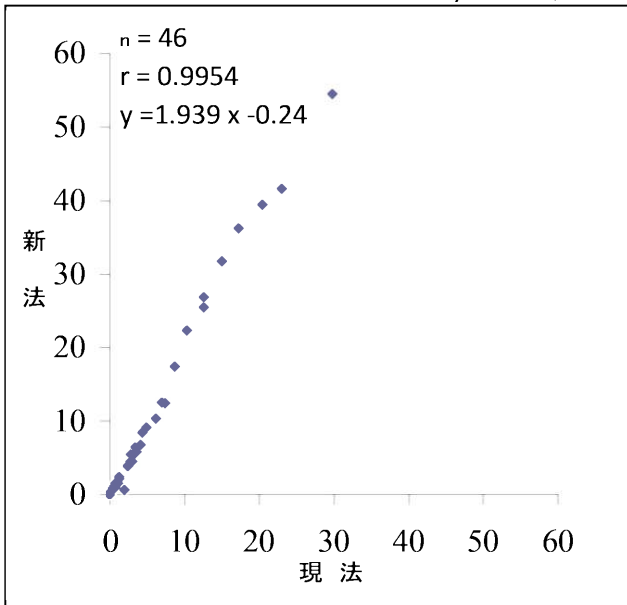

●PRL現法と新法の比較 (単位: ng/mL)

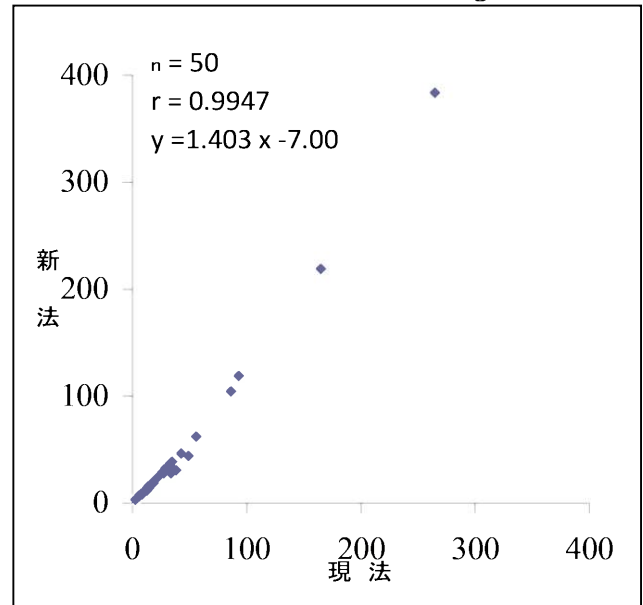

(委託先検討資料)