

## 測定方法変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記検査項目におきまして検査項目見直しにともない測定方法の変更をさせていただきますのでご案内いたします。

なお、基準値の変更はありません。

誠に勝手ではございますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〈実施日〉

平成 27 年 4 月 1 日 (水) 受付分より

コード	項目名	変更内容	新	現
0257	HBA1c	測定方法	酵素法	ラテックス凝集反応法

\* 基準値の変更はありません。現法と新法の比較、裏面参照下さい。



(株)ジャパンメディカル  
山梨県中央市乙黒354-11  
TEL 055(220)4155代表

\* 現法と新法の比較


0257 : HBA1c

N=50

$\gamma = 0.9868$

$Y = 0.9873 X + 0.01$

新法  
(酵素法)

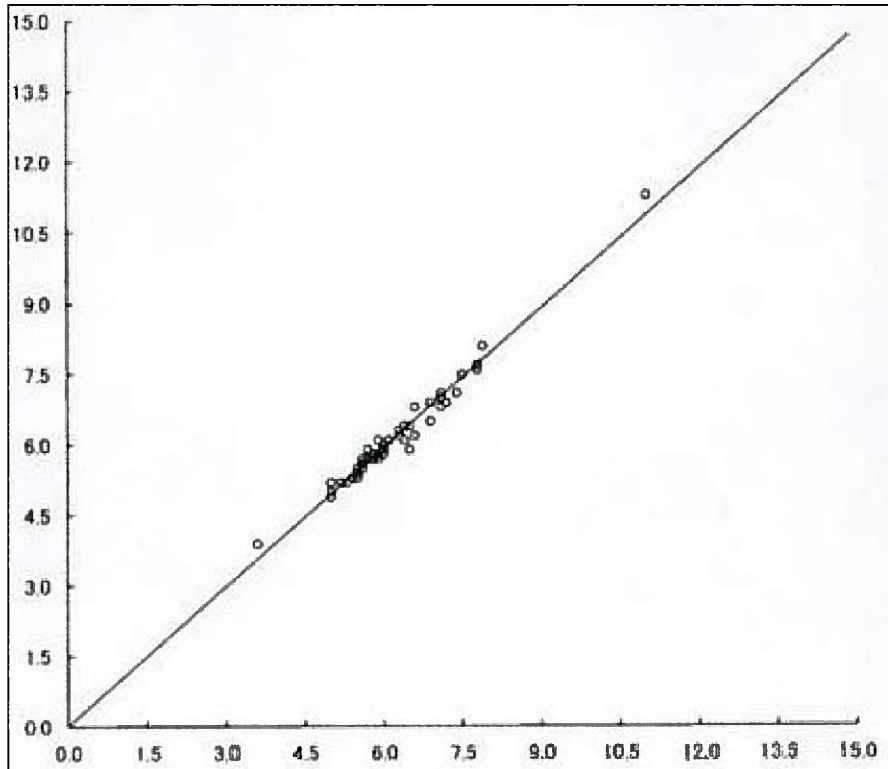

現法 (ラテックス凝集法)