

検査内容変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび、下記検査項目につきまして、現試薬の販売中止に伴い
 測定試薬を変更させていただきたくご案内いたします。
 何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

〈変更実施日〉

平成 28 年 2 月 1 日 (月) ご依頼分より

コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
0913	レニン活性	検体必要量	血漿 0.3ml	血漿 0.9ml	試薬発売中止に伴う検査内容の変更となります
		基準値	臥位 0.3~2.9 立位 0.3~5.4	臥位 0.2~2.7 立位 0.2~3.9	
		単位	ng/ml/h	ng/ml/h	
		所要日数	3~5 日	2~4 日	

外注先 保健科学




(株)ジャパンメディカル

山梨県中央市乙黒354-
 TEL 055(220)4155代表

▼ 現試薬と新試薬の比較

〔5025：レニン活性（PRA）〕

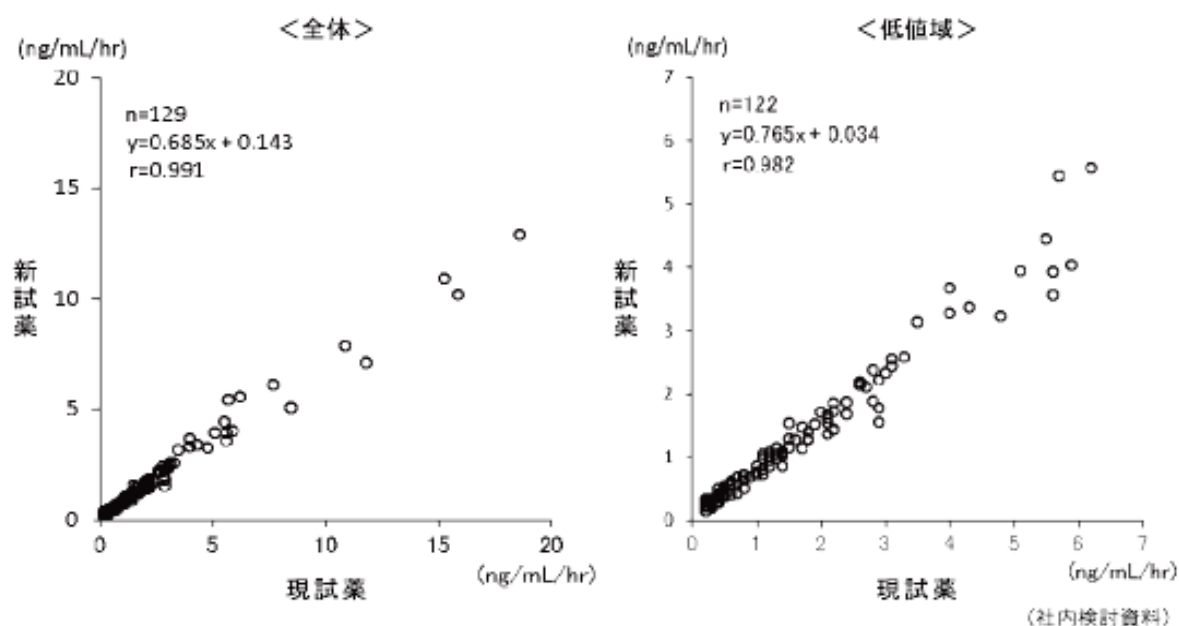

※レニン活性（PRA）において、新試薬は現試薬と比較し測定結果が低く出る傾向にあります。これはレニン活性の標準物質に国際標準品が無く、試薬毎の基準に則り値付けをしていることによります。