

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、下記検査項目の内容を一部変更をさせていただきますので、
ご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- 実施日 2023年6月1日（木）受付分より
- 検査内容変更項目

● CK-MB	● ミオグロビン定量
---------	------------


- 検査変更内容

項目	変更内容	新	現	備考
CK-MB	項目コード	0783	0186	測定試薬 変更のため
	検査方法	CLEIA法	CLIA法	
	基準値	0.6 ~ 6.3 ng/mL	0.9 ~ 5.9 ng/mL	
ミオグロビン定量	項目コード	0950	0920	測定試薬 変更のため
	検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL	
	検査方法	CLEIA法	CLIA法	
	基準値	男性 17.4~105.7 女性 14.3~ 65.8 ng/mL	85以下 ng/mL	


* 相関図につきましては、裏面の参照をお願いいたします。*

■ 新試薬と旧試薬の比較

・CK-MB

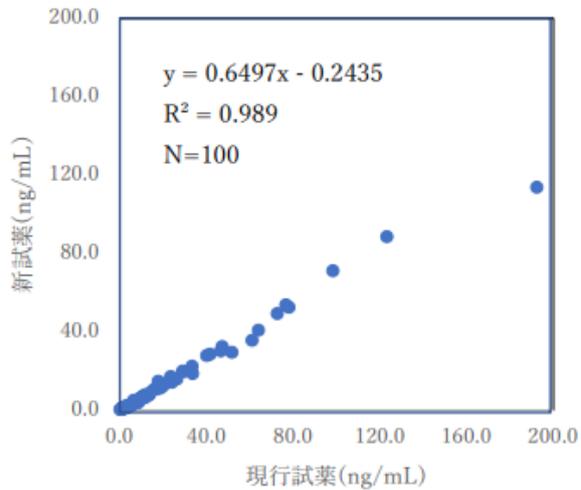

・ミオグロビン定量

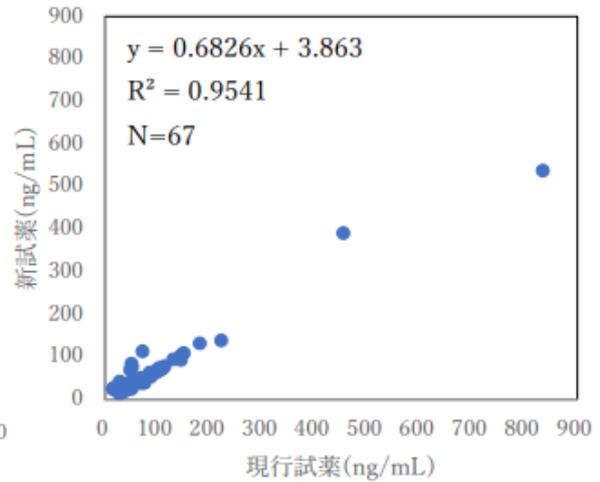

■ 検査方法参考文献

- ・CK-MB Mass Test in Ischemic Myocardial Injury, Comparison of Two Tests: Biomerieux Vidas and Sanofi Access Immunoassays, Journal of Clinical Laboratory Analysis, Sophie Poirey 他〔CK-MB〕
- ・Multicenter Evaluation of Five Assays for Myoglobin Determination, Clinical Chemistry, Martina Zaninotto 他〔ミオグロビン定量〕